

バッテリーレス in vivo 無線通信用 PIM 変調回路の設計

- Design of batteryless in vivo wireless PIM communication circuit -

東京工業大学 統合研究院 益研究室
Masu Laboratory, Integrated Reseach Institute, Tokyo Institute of Technology

小林 由佳, 石田 光一, 益 一哉
Yuka Kobayashi, Koichi Ishida, Kazuya Masu

1. 背景 と 目的

Background & Purpose


日常的な健康管理や診察において

- ・センサで体内の健康情報を測定
- ・その結果を無線で体外へ送信


低侵襲で手軽に行える

- ・より低侵襲で扱いやすい大きさに

バッテリーレスなセンサモジュールの検討

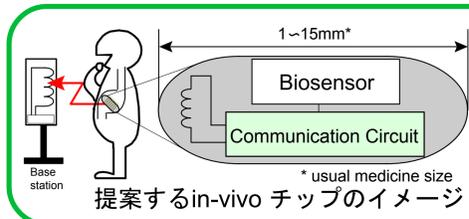

薬のように服用して、苦痛なく消化器系の検査を行い、瞬時に検査結果を知ることが可能
↓
手軽さとコスト削減

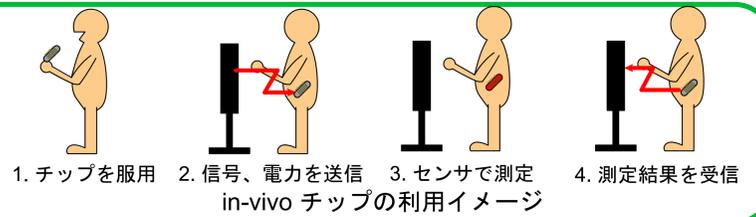

目的 : in vivo無線通信システムの実現
Purpose : Realize of in-vivo wireless communication system

2. バイオセンサ



Biosensor

- ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor)

…表面のイオン濃度に応じて出力電圧が変化する素子

pHセンサとして使用される

今回はISFETによる胃液のpH情報のみ通信することを仮定

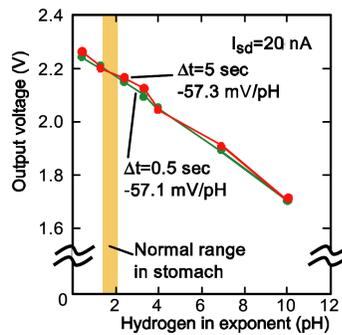

3. 通信仕様

Communication Specifications


- バッテリーレスで人体を通しての通信

- ・電磁波 (電界) の減衰が大きい
- ・人体内で減衰量が変化する
- ・人体への影響
- ・電力が限られている

→ これらを考慮して通信仕様を決定


伝送方式 -transmission system-

電磁波伝送

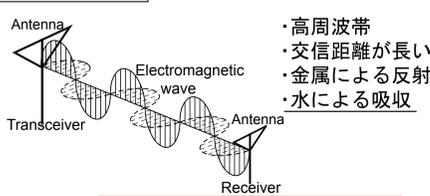

- ・高周波帯
- ・交信距離が長い
- ・金属による反射
- ・水による吸収

電磁結合伝送

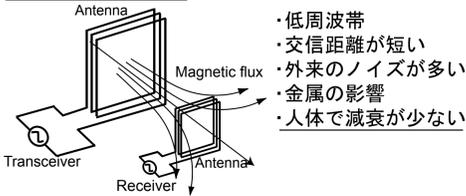

- ・低周波帯
- ・交信距離が短い
- ・外来のノイズが多い
- ・金属の影響
- ・人体で減衰が少ない

→ 電磁結合伝送方式採用

周波数帯 -frequency band-

- ・ISM (Industrial, Scientific, Medical) バンドである
- ・高周波では人体での減衰が大きい


→ 13.56MHz採用

変調方式 -modulation-

Pulse Interval Modulation (PIM)

複数パルスの発生する時間間隔を用いたデータ伝送

- 《特徴》
- ・発振器が不要
- ・減衰の変動に強い
- ・伝送レートは高くない




Modulation	ASK	FSK	PSK	PIM*
Attenuation	×	○	○	○
Power consumption	○	×	○	○
Bit rate	△	○	○	△


- ・AM変調…減衰に弱い
- ・FM/PM変調…発振器が不要
- ・pH情報のみ通信

→ PIM採用 但し、検波しやすいように電力供給を止めるために電力をキャパシタに蓄えておく

通信の様子 -total communication-



①の信号波形



②の信号波形

まとめ -conclusion-


日常的な診断や健康管理に用いやすいように低侵襲かつ扱いやすい大きさが期待できるバッテリーレスセンサモジュールを用いた in vivo 無線通信システムのパルス変調回路について検討した。人体からの減衰を考慮して通信仕様を検討し、バッテリーレス in vivo 無線通信回路を設計した。ADSによりシミュレーションを行ったところ PIM 変調を行っていることを確認した。これによって電池を使用せず、より安全な体内の生体情報を測定するセンサモジュールの実現可能性が示された。今後はベースステーションやアンテナについても検討していく予定である。

4. 提案回路


The proposed Communication circuit

回路設計 -circuit design-

- 提案システムの概略図

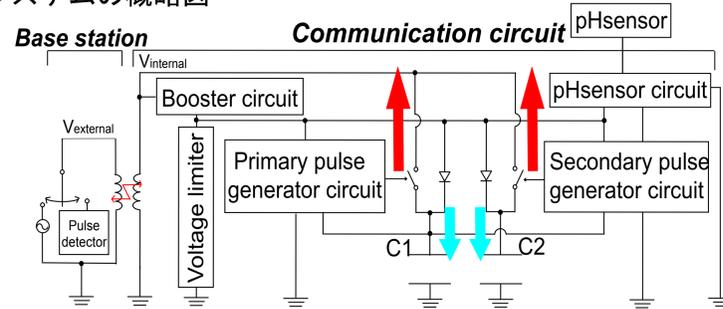


- 通信回路

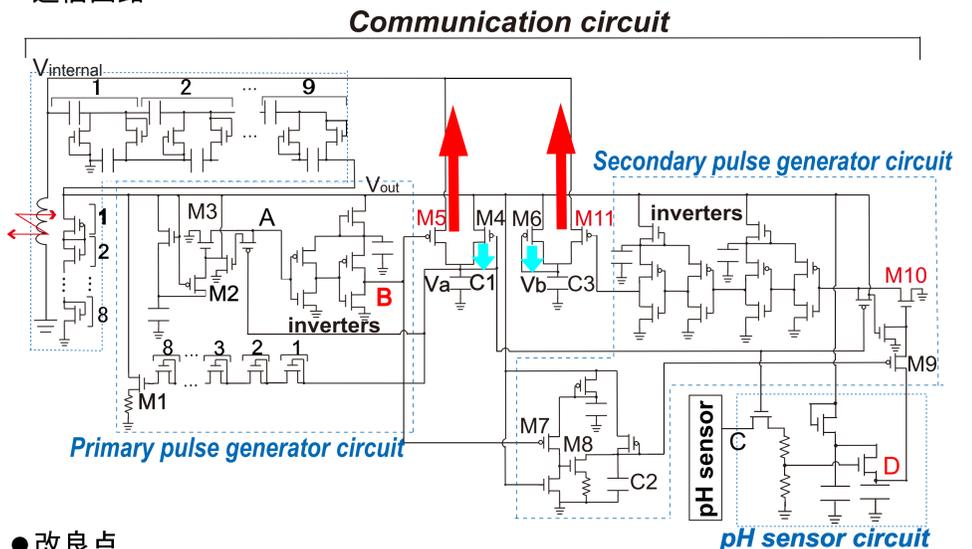



- 改良点

- ・インバータの挿入
- ・レベルシフタの挿入

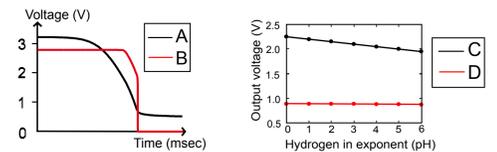

シミュレーション -simulation-

アンテナの結合係数0.011、ベースステーションから13.56MHzの正弦波で充電したときのシミュレーション結果

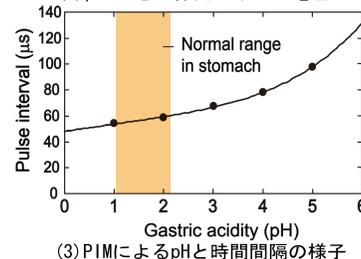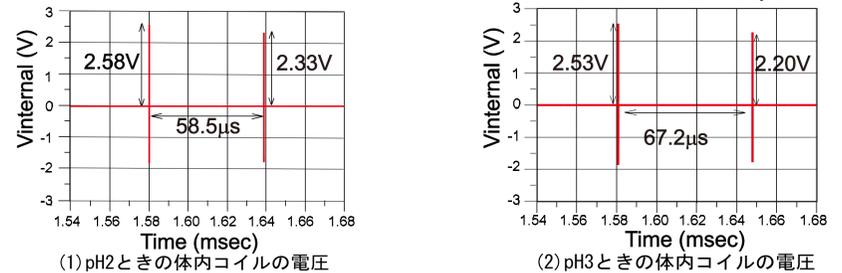

pH感度は4μs/pH
パルス振幅は2V以上
↓
ベースステーションで検波可能